
Ürün bilgileri

Tam otomatik analog indikatör test tezgahı Precimar ICM 100 IP

Ambalaj içeriği
RS232C kukla modem kablosu, USB kablosu, Destek kolu/ kelepçe Ø12 mm, Bağlama milini Ø12 mm'den Ø8 mm'e düşürme burcu, güç kaynağı, kalibrasyon sertifikası

Uygulama

- Analog indikatör, analog test indikatörü ölçüm cihazları ve analog komparatörlerinin kalibrasyonu
- Precimar MSW 100 yazılım sistemi analog indikatör test cihazını kontrol eder, kamera görüntüsünü (test nesnesinin ibresi veya sayısal gösterimi) ve analog indikatör test cihazının referans ölçüm değerlerini işler ve ayrıca test ekipmanı yönetiminin bir parçası olarak sonraki tüm işlemleri gerçekleştirir.
- Test rutini DIN, VDI, DKD veya DAkkS yönergelerine, çeşitli uluslararası standartlara veya şirketin iç spesifikasyonlarına göre uygulanabilir.
- Test nesneleri arasındaki sapmalar, test sırasında bir grafikte gösterilir.

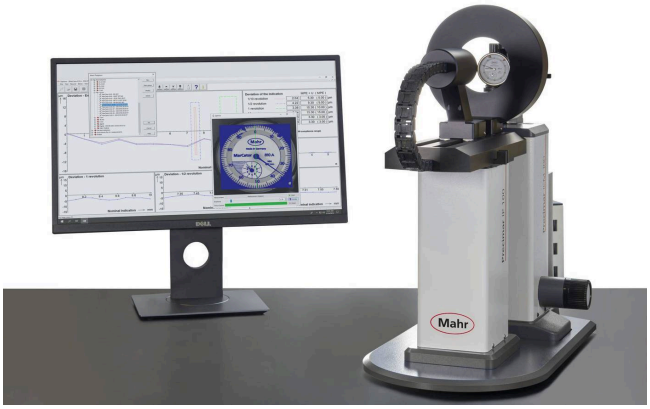

Malzeme no.: **5351020**

Teknik veriler

Dijital sayısal artım [µm]	0,02
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0.1 + L/250)
Kütle [kg]	45

Ürün bilgileri


Tam otomatik analog indikatör test tezgahı Precimar ICM 100 IP

Ambalaj içeriği

RS232C kukla modem kablosu, USB kablosu, Destek kolu/ kelepçe Ø12 mm, Bağlama milini Ø12 mm'den Ø8 mm'e düşürme burcu, güç kaynağı, kalibrasyon sertifikası

Uygulama

- Calibration of dial gages, dial test indicators and dial comparators
- The Precimar MSW 100 software controls the dial gage tester, evaluates the camera image (scale or numerical display of the test specimen) and the reference measured values of the dial gage tester as well as the other downstream processes within the scope of test equipment management.
- The test procedure can be based on DIN, VDI, DKD or DAkkS regulations, various international standards or internal company specifications.
- The deviations of the test specimens are immediately processed graphically during the test.

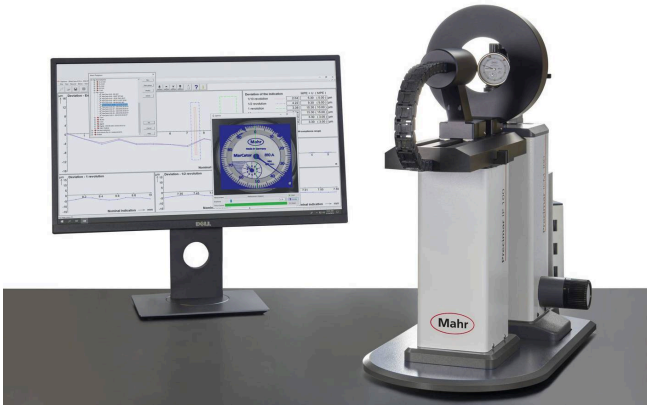

Malzeme no.: **5351021**

Teknik veriler

Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	100
Dijital sayısal artım [µm]	0,02
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0.1 + L/250)
Kütle [kg]	45